

*Pool* **LAB 2.0<sup>®</sup>**  
PHOTOMETER



Measuring water  
parameters



Измерьте  
параметры воды



**POOLLAB 2.0® WEBSITE**



**POOLLAB 2.0® YOUTUBE CHANNEL**

General test informations   Общие сведения о тестировании	6
Notes   Примечания	7
Hardness Conversion   Преобразование твердости	10
OR/UR	11
Tolerances   Допуски	12
Countdown   Обратный отсчет	13
<b>ZERO</b>	<b>15</b>
Single Parameter Quick Start Guide   Краткое руководство по работе с одним параметром	20
Multiple Parameter Quick Start Guide   Краткое руководство по работе с несколькими параметрами	26

## TEST – Instructions | Инструкции

Active Oxygen (MPS/O <sub>2</sub> )	1-ACT	38
★ Alkalinity (CaCO <sub>3</sub> )	2-TA	44
Aluminium (Al <sup>3+</sup> )	3-ALU	50
Ammonia (NH <sub>3</sub> )	4-AMM	56
Bromine (Br <sub>2</sub> )	5-BRO	62
Calcium Hardness (CaCO <sub>3</sub> )	6-CH	70
Chloramine (NH <sub>2</sub> Cl/NHCl <sub>2</sub> )	7-CLA	76
★ Chlorine (Cl <sub>2</sub> )	8-CL	86
Chlorine HR (Cl <sub>2</sub> )	9-CLHR	94
Chlorine Dioxide (ClO <sub>2</sub> )	10-CLO2	100
Copper (Cu <sup>2+</sup> )	11-CU	108
★ Cyanuric Acid (CYA)	12-CYA	114

 = Most used | Самые используемые

**TEST – Instructions | Инструкции**

Hydrogen Peroxide LR ( $\text{H}_2\text{O}_2$ )	13–HYDL	120
Hydrogen Peroxide HR ( $\text{H}_2\text{O}_2$ )	14–HYDH	126
Iron LR ( $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ )	15–IRON	132
Nitrate ( $\text{NO}_3^-$ )	16–NTRA	136
Nitrite LR ( $\text{NO}_2^-$ )	17–NITRI	142
Ozone ( $\text{O}_3$ )	18–OZON	146
☆ pH	19–PH	152
PHMB	20–PHMB	158
Phosphate LR ( $\text{PO}_4^{3-}$ )	21–PPLR	164
Phosphate HR ( $\text{PO}_4^{3-}$ )	22–PPHR	170
Potassium ( $\text{K}^+$ )	23–POT	176
Sulphate ( $\text{SO}_4^{2-}$ )	24–SULF	180
Total Hardness ( $\text{CaCO}_3$ )	25–TH	184
Urea ( $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ )	26–UREA	190
Zinc with Chlorine ( $\text{Zn}^{2+}$ )	27–ZINC	198

☆ = Most used | Самые используемые



# **General test information**

## **Общая информация об испытаниях**

Notes   Примечания	7
Hardness Conversion   Преобразование твердости	10
OR/UR	11
Tolerances   Допуски	12
Countdown   Обратный отсчет	13



## Only Single



The parameter to be measured may only be measured stand-alone (so NOT in parallel with other parameters).



Измеряемый параметр может измеряться только отдельно (то есть НЕ параллельно с другими параметрами).


## Only Chamber 2



The parameter to be measured may only be measured in the middle measuring chamber (2).




Измеряемый параметр может быть измерен только в средней измерительной камере (2).



To prevent cross-contamination, your PoolLab 2.0® comes with 3 different coloured stirring rods. It is recommended to not use the same stirring rod (e.g. just the white one) when performing parallel measurements, but to use a different one for each chamber.



Чтобы предотвратить перекрестное загрязнение, в комплект PoolLab 2.0® входят 3 разноцветных стержня для перемешивания. Рекомендуется не использовать одну и ту же палочку для перемешивания (например, только белую) при проведении параллельных измерений, а использовать разные палочки для каждой камеры.



## Photometer

## Rapid

## Tablet Count



Always use PHOTOMETER grade tablets! Never use RAPID grade tablets!  
RAPID tablets lead to incorrect measurement results!  
Do not touch reagent tablets!



Всегда используйте таблетки класса PHOTOMETER! Никогда не используйте планшеты класса RAPID! Таблетки RAPID приводят к неправильным результатам измерений! Не прикасайтесь к таблеткам с реактивами!



	CaCO <sub>3</sub> mg/l	K <sub>S,4,3</sub> mmol/l	°dH (KH)	°e (CH)	°f (DC)	mval
1 mg/l CaCO <sub>3</sub>	1	0.01	0.056	0.07	0.1	0.02
1 mmol/l K <sub>S,4,3</sub>	100	1	5.6	7.0	10.0	2

For more information, visit  
<https://www.water-id.com/service/manual> or follow the QR-Code:



Для получения дополнительной информации посетите сайт  
<https://www.water-id.com/service/manual> или воспользуйтесь QR-кодом:

**OR = Overrange / UR = Underrange.**

Test result is outside the range of this method. OR results can be brought into measurement range by dilution. Use syringe to take only 5 ml (or 1 ml) sample water plus 5 ml (9 ml) distilled water. Test again and multiply results times 2 (times 10). Dilution does not work with „pH“ measurement.

**OR = превышение диапазона (выше диапазона измерения) /****UR = понижение диапазона (ниже диапазона измерения)**

Результат теста находится за пределами диапазона измерений данного метода. Результаты ИЛИ можно ввести в диапазон измерения путем разбавления. Используйте шприц и наберите 5 мл (или 1 мл) воды для тестирования плюс 5 мл (9 мл) дистиллированной воды. Выполните тест и умножьте результат на 2 (умножьте на 10). Разбавление не применимо к параметру "pH".



Under laboratory conditions, the instrument-/reagent- and user-related tolerances can be up to +/- 10 % of the actual value. For the parameter „pH“ a tolerance of up to +/- pH 0,10 applies.



В лабораторных условиях допуски прибора/реагента и пользователя могут составлять до +/- 10 % от фактического значения. Для параметра "рН" действует допуск до +/- pH 0,10.



(For simultaneous measurement of several parameters:) Pressing the respective „T“ button confirms to the PoolLab 2.0® that the reagent has been dissolved and the countdown (reaction time) can begin. The actual measurement is not triggered until the „OK/TEST“ button is pressed. If a countdown expires before the „OK/TEST“ button is pressed, the parameter abbreviation above the T button is displayed in orange. This indicates that the reaction time has been exceeded. For some parameters, exceeding the reaction time can lead to incorrect measurement results. For these parameters, the clock symbol changes from green to red.



(Для одновременного измерения нескольких параметров:) Нажатие соответствующей кнопки "T" подтверждает PoolLab 2.0®, что реагент растворен и можно начинать обратный отсчет (время реакции). Фактическое измерение начинается только после нажатия кнопки "OK/TEST". Если обратный отсчет истекает до нажатия кнопки "OK/TEST", аббревиатура параметра над кнопкой T отображается оранжевым цветом. Это означает, что время реакции превышено. Для некоторых параметров превышение времени реакции может привести к неправильным результатам измерений. Для таких параметров символ часов меняется с зеленого на красный.



# ZERO





- 1) The countdown(s) can be skipped by pressing the „on/off“ key after confirming the last measurement chamber (not recommended).
- 2) The „back“ (ZERO) key can be used to cancel an accidental confirmation that the reagent has been added („T“ key).
- 3) Pressing the „OK/TEST“ key again triggers a repeat measurement.



- 1) Обратный отсчет можно пропустить, нажав клавишу "вкл/выкл" после подтверждения последней камеры измерения (не рекомендуется).
- 2) Клавиша "назад" (ZERO) может использоваться для отмены случайного подтверждения добавления реагента (клавиша "T").
- 3) Повторное нажатие клавиши "OK/TEST" вызывает повторное измерение.

**Only one time per test batch**

The „ZERO“ step is only necessary once after switching on. Make sure that the water to be measured does not (!) contain any tablet/reagent in the cuvette and that the light protection cover is in place. Please always perform ZERO with the pool water to be measured. You can also perform another ZERO before each new measurement (display shows „TEST“) (fill cuvettes with pool water, put on lid, press ZERO key).

**Только один раз для каждой тестовой партии**


Шаг „ZERO“ необходимо выполнить только один раз после включения. Убедитесь, что измеряемая вода не содержит (!) никаких таблеток/реагентов в кювете и что светозащитная крышка установлена на место. Пожалуйста, всегда выполняйте ZERO с водой в бассейне, которую необходимо измерить. Перед каждым новым измерением (на дисплее отображается „TEST“) можно выполнить еще один ZERO (заполните кюветы водой из бассейна, поставьте крышку, нажмите кнопку ZERO).

**1**

Clean the cuvette  
Очистите кювету

**2**

Take water from your pool  
Возьмите воду из бассейна

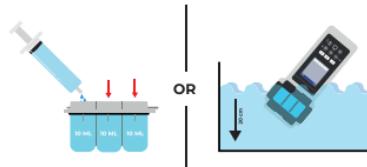**3**

No Reagents!  
Никаких реагентов!

**4**

5



6





## Single Parameter Один параметр



2 s: Opens parameter list  
1x short: Starts countdown/TEST (parallel measurement)  
2x short: Deletes the selected parameter



2 s: Открывает список параметров  
1x короткие: Запуск обратного отсчета/тестирования  
(параллельное измерение)  
2x короткие: Удаление выбранного параметра

Quick Guide available on [poollab.org](http://poollab.org).

Краткое руководство доступно на сайте [poollab.org](http://poollab.org).






1



2



3



— OR —



4





5



6



7




8





9

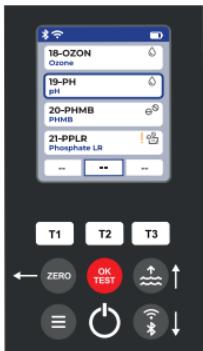

10



11



12




13




14



15

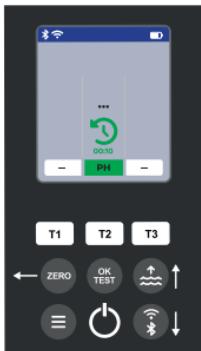

16

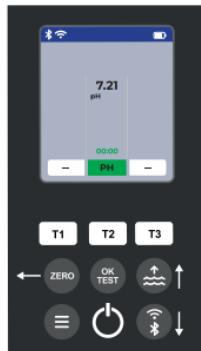



## Multiple Parameters Несколько параметров



2 s: Opens parameter list  
1x short: Starts countdown/TEST (parallel measurement)  
2x short: Deletes the selected parameter



2 s: Открывает список параметров  
1x короткие: Запуск обратного отсчета/тестирования  
(параллельное измерение)  
2x короткие: Удаление выбранного параметра

Quick Guide available on [poollab.org](http://poollab.org).

Краткое руководство доступно на сайте [poollab.org](http://poollab.org).






1



2



3



No Reagents!  
Ни каких  
реагентов!



4





5



6



7



8





9



10



11



12



13



14



15



16





17



18



19



20



21



22



23



24





25



26



27



28





29



30



31



32





33



# TEST

TEST – Instructions | Инструкции

Active Oxygen (MPS/O <sub>2</sub> )	1-ACT	38
☆ Alkalinity (CaCO <sub>3</sub> )	2-TA	44
Aluminium (Al <sup>3+</sup> )	3-ALU	50
Ammonia (NH <sub>3</sub> )	4-AMM	56
Bromine (Br <sub>2</sub> )	5-BRO	62
Calcium Hardness (CaCO <sub>3</sub> )	6-CH	70
Chloramine (NH <sub>2</sub> Cl/NHCl <sub>2</sub> )	7-CLA	76
☆ Chlorine (Cl <sub>2</sub> )	8-CL	86
Chlorine HR (Cl <sub>2</sub> )	9-CLHR	94
Chlorine Dioxide (ClO <sub>2</sub> )	10-CLO2	100
Copper (Cu <sup>2+</sup> )	11-CU	108
☆ Cyanuric Acid (CYA)	12-CYA	114
Hydrogen Peroxide LR (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	13-HYDL	120
Hydrogen Peroxide HR (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	14-HYDH	126
Iron LR (Fe <sup>2+/3+</sup> )	15-IRON	132
Nitrate (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	16-NTRA	136
Nitrite LR (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	17-NITRI	142
Ozone (O <sub>3</sub> )	18-OZON	146
☆ pH	19-PH	152
PHMB	20-PHMB	158
Phosphate LR (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	21-PPLR	164
Phosphate HR (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	22-PPHR	170
Potassium (K <sup>+</sup> )	23-POT	176
Sulphate (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	24-SULF	180
Total Hardness (CaCO <sub>3</sub> )	25-TH	184
Urea ((NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CO)	26-UREA	190
Zinc with Chlorine (Zn <sup>2+</sup> )	27-ZINC	198

☆ = Most used | Самые используемые





1-ACT

## Active Oxygen (MPS) Активный кислород (MPS)

0.00 – 20.00 mg/l (ppm) O<sub>2</sub>

DPD N°4 Photometer\*

\*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2**

Same source as Zero

**OR****3****4****5**

6



7



8



$\ominus$   
1 x DPD N°4  
Photometer

9



Completely Dissolved  
  
NO Residue  


10



11



If **multiple** parameters:  
See [page 26](#)



12



13





**2-TA**



## Alkalinity Щелочность

**Tablet Mode:**  
0 – 200 mg/l (ppm)  $\text{CaCO}_3$

Alkalinity-M Photometer

**Liquid Mode:**  
0 – 200 mg/l (ppm)  $\text{CaCO}_3$

Alkalinity-M Liquid\*

\*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



1 x Alkalinity-M  
Photometer

— OR —

6 Alkalinity-M  
Liquid

9




Completely  
Dissolved

NO Residue

10



11

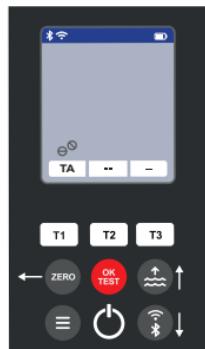

If **multiple** parameters:  
See [page 26](#)



12



13







3-ALU



ONLY SINGLE

## Aluminium Алюминий

0.00 – 0.30 mg/l (ppm) Al<sup>3+</sup>

- Aluminium N°1 Photometer\*
- Aluminium N°2 Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



9



10

1x Aluminium N°2  
Photometer

11

Completely  
Dissolved

NO Residue

12



13



14



15







4-AMM



## Ammonia Аммиак

0.00 – 1.20 mg/l (ppm) NH<sub>3</sub>

Ammonia N°1 Powder Pillows\*

Ammonia N°2 Powder Pillows\*

\*not part of standard equipment


If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.

Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



PP  
1 x Ammonia N°1  
Photometer

9



10

1x Ammonia N°2  
Photometer

11



Completely Dissolved

NO Residue

12



13



14



15





# 5-BRO



## Bromine Бром

### Tablet Mode:

0.00 – 13.00 mg/l (ppm)  $\text{Br}_2$

DPD N°1 Photometer  
Glycine\*

### Liquid Mode:

0.00 – 9.00 mg/l (ppm)  $\text{Br}_2$

DPD 1A\*  
DPD 1B\*  
Glycine\*

\*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



If your sample contains chlorine as well as bromine (due to disinfectants containing bromine and chlorine), carry out procedure "A". If you are unsure whether the sample contains chlorine, also carry out procedure "A" to obtain a correct measurement result. If the sample does not contain chlorine, follow procedure "B".



Если образец содержит хлор, а также бром (из-за дезинфицирующих средств, содержащих бром и хлор), выполните процедуру "A". Если вы не уверены, что образец содержит хлор, также выполните процедуру "A", чтобы получить правильный результат измерения. Если образец не содержит хлора, выполните процедуру "B".

**A With Chlorine | С хлором****7A****8A** $\ominus\ominus$   
1 x Glycine**9A****10A**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

 $\ominus\ominus$   
1 x DPD N°1  
Photometer

---

**OR**

---

3 DPD 1A  
3 DPD 1B

**A With Chlorine | С хлором****11A****12A****13A**

If **multiple** parameters:  
See page 26




**A With Chlorine | С хлором****14A****15A**

**B Without Chlorine | Без хлора****7B****8B**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

1 x DPD N°1  
Photometer

— OR —

3 DPD 1A  
3 DPD 1B**9B**Completely  
Dissolved

NO Residue

**10B**

**B** Without Chlorine | Без хлора

11B



If **multiple** parameters:  
See page 26



12B



13B



OR  
↑  
500  
+  
+  
+  
+  
250  
+  
+  
+  
0

6-CH



## Calcium Hardness Твердость кальция

0 – 500 mg/l (ppm) CaCO<sub>3</sub>

- 滴 Calcium Hardness N°1\*
- 滴 Calcium Hardness N°2\*

\*not part of standard equipment


If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.

Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17







7-CLA

## Chloramines Хлорамины

0.00 – 6.00/8.70/14.50 mg/l (ppm) fCl<sub>2</sub>/NH<sub>2</sub>Cl/NHCl<sub>2</sub>

- DPD N°1 Photometer
- DPD N°2 Photometer\*
- DPD N°3 Photometer

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



2

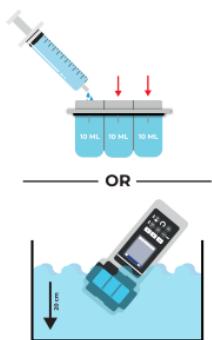

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



If **multiple** parameters:  
See page 26



15



16

Result of **free Chlorine**.  
Continue for **Monochloramines**.



17



18



19



20



21



22



23

Result of **Monochloramines**.  
Continue for **Dichloramines**.



24



25



26



27



28



29



30

Result of Dichloramines.





## 8-CL



### Chlorine (fCl/cCl/tCl) Хлор (fCl/cCl/tCl)

#### Tablet Mode:

0.00 – 6.00 mg/l (ppm) Cl<sub>2</sub>

DPD N°1 Photometer  
DPD N°3 Photometer

#### Liquid Mode:

0.00 – 4.00 mg/l (ppm) Cl<sub>2</sub>

DPD 1A\*  
DPD 1B\*  
DPD 3C\*

0.00

\*not part of standard equipment




If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.



Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



⊖  
1x DPD N°1  
Photometer

— OR —

3 DPD 1A  
3 DPD 1B

9



Completely  
Dissolved

NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:  
See page 26



12



13

Result of **free Chlorine**.  
Continue for **total Chlorine**.



14



15

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



$\ominus$   
1x DPD N°3  
Photometer

— OR —

$\bullet$   
3 x DPD 3C

16



Completely  
Dissolved

NO Residue

17



18



19



20

Result of **total Chlorine**.  
Continue for **combined Chlorine**.



21



22

Result of combined Chlorine.







9-CLHR

## Chlorine HR (KI) Хлор HR (КІ)

5 – 200 mg/l (ppm) Cl<sub>2</sub>

Chlorine HR (KI)\*

Acidifying GP\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



7




8



1x Acidifying GP

9



10

1x Chlorine HR  
(KI)

11

Completely  
Dissolved

12



13



If **multiple** parameters:  
See **page 26**



14



15





OR  
↑  
11.00

10-CLO2

OR  
↑  
7.50

## Chlorine Dioxide Диоксид хлора

5.50  
0.00

3.00  
0.00

Tablet Mode:  
0.00 – 11.00 mg/l (ppm) ClO<sub>2</sub>

DPD N°1 Photometer  
Glycine\*

Liquid Mode:  
0.00 – 7.50 mg/l (ppm) ClO<sub>2</sub>

DPD 1A\*  
DPD 1B\*  
Glycine

\*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



If your sample contains chlorine in addition to chlorine dioxide (due to disinfectants containing chlorine dioxide and chlorine), carry out procedure "A". If you are unsure whether the sample contains chlorine, also carry out procedure "A" to obtain a correct measurement result. If the sample does not contain chlorine, follow procedure "B".



Если образец содержит хлор в дополнение к диоксиду хлора (из-за дезинфицирующих средств, содержащих диоксид хлора и хлор), выполните процедуру "A". Если вы не уверены, что образец содержит хлор, также выполните процедуру "A", чтобы получить правильный результат измерения. Если образец не содержит хлора, выполните процедуру "B".

**A With Chlorine | С хлором****7A****8A****9A****10A**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



— OR —

3 DPD 1A  
3 DPD 1B

**A With Chlorine | С хлором****11A****12A****13A**

If **multiple** parameters:  
See page 26



**A** With Chlorine | С хлором**14A****15A**

**B** Without Chlorine | Без хлора**7B****8B**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

1 x DPD N°1  
Photometer

— OR —

3 DPD 1A  
3 DPD 1B**9B**Completely  
Dissolved

NO Residue

**10B**

**B** Without Chlorine | Без хлора

11B



If multiple parameters:  
See page 26



12B



13B





11-CU

## Copper Медь

0.00 – 5.00 mg/l (ppm) Cu<sup>2+</sup>

- Copper N°1 Photometer\*
- Copper N°2 Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.



Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



1 x Copper N°1  
Photometer

9



Completely Dissolved  
No Residue

10



11



If **multiple** parameters:  
See **page 26**



12

Result of **free Copper**.  
Continue for **total Copper**.



13



14

1x Copper N°2  
Photometer

15



16



17



18

Result of **total Copper**.  
Continue for **combined Copper**.



19



20

Result of **combined Copper**.



OR  
↑  
100  
+  
+  
+  
50  
+  
+  
+  
0

12-CYA



## Cyanuric Acid циануровая кислота

0 – 100 mg/l (ppm) CYA

CYA Test Photometer




If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.



Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



1 x CYA Test  
Photometer

9



Completely Dissolved  
No Residue

10



11



If **multiple** parameters:  
See page 26



12



13







13-HYDL

## Hydrogen Peroxide LR Перекись водорода LR

0.00 – 2.40 mg/l (ppm) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Hydrogen Peroxide LR Photometer\*

\*not part of standard equipment




If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6

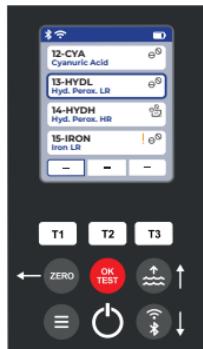

7



8



1x Hydrogen Peroxide LR  
Photometer

9




Completely Dissolved  
No Residue


10



11

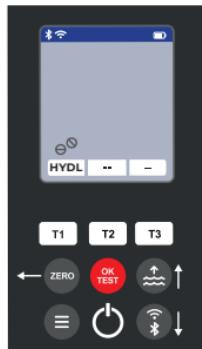


If **multiple** parameters:  
See [page 26](#)

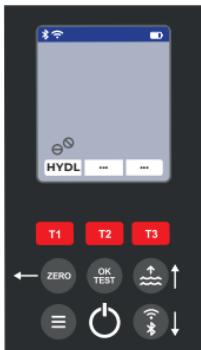

12



13

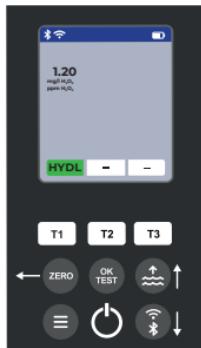





14-HYDH

## Hydrogen Peroxide HR Перекись водорода HR

0 – 180 mg/l (ppm) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Hydrogen Peroxide HR Photometer\*  
Acidifying PT\*


\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.

Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1

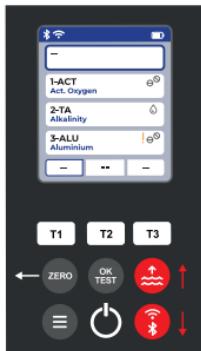

**2****OR****3****4****5**

6



7



8



1 x Acidifying PT  
⊖

9



Completely Dissolved  
✓  
NO Residue  
✗

10



1x Hydrogen Peroxide HR Photometer



11



Completely Dissolved




NO Residue


12



13

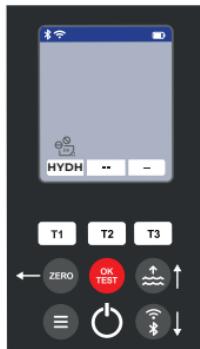


If **multiple** parameters:  
See **page 26**

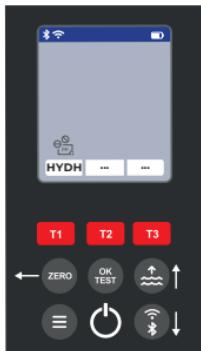


14



15

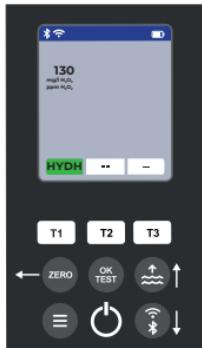





15-IRON



ONLY SINGLE

## Iron LR Железный LR

0.00 – 1.00 mg/l (ppm) Fe<sup>2+</sup>/Fe<sup>3+</sup>

Iron LR Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



9



10



11



12



13





16-NTRA



## Nitrate Нитрат

1 – 50 mg/l (ppm)  $\text{NO}_3^-$

PP: Nitrate N°1 Photometer\*

PP: Nitrate N°2 Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1




**2****OR****3****4****5**


6



7

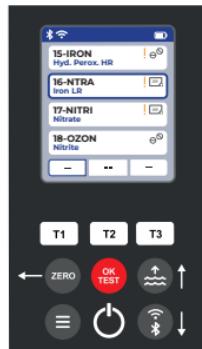


8

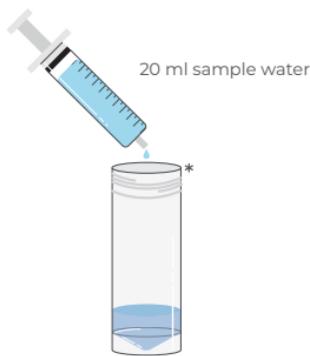

\*not part of standard equipment


9

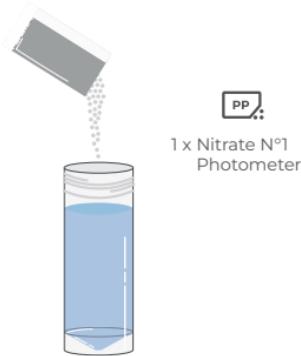

10

1x Nitrate N°2  
Photometer


11

Shake for  
15 seconds.

12



13



Take 10 ml

14



15



16



17



18





17-NITRI



## Nitrite Нитриты

0.00 – 1.50 mg/l (ppm) NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

Nitrite LR Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.



Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



1x Nitrite LR Photometer

9



-  Completely Dissolved
-  NO Residue

10



11



12



13



# 18-OZON



## Ozone Озон

### Tablet Mode: 0.00 – 4.00 mg/l (ppm) O<sub>3</sub>

DPD N°1 Photometer  
DPD N°3 Photometer  
Glycine\*

### Liquid Mode: 0.00 – 2.70 mg/l (ppm) O<sub>3</sub>

DPD 1A\*  
DPD 1B\*  
DPD 3C\*  
Glycine\*


\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.

Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6



If the water sample contains chlorine as well as ozone, an incorrect measurement result (ozone incl. chlorine) is displayed.



Если образец воды содержит хлор, а также озон, отображается неверный результат измерения (озон вкл. хлор).

**7****8**


Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



1 x DPD N°1  
Photometer  
1 x DPD N°3  
Photometer



3 DPD 1A  
3 DPD 1B  
3 DPD 3C

**— OR —****9**Completely  
Dissolved

NO Residue

**10**

11



If **multiple** parameters:  
See page 26



12



13





# 19-PH



pH

## Tablet Mode:

6.50 – 8.40 pH

Phenol Red Photometer

## Liquid Mode:

6.50 – 8.40 pH

Phenol Red Liquid\*




If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.



Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



$\ominus$   
1x Phenol Red  
Photometer

— OR —

6 Phenol Red  
Liquid

9



Completely Dissolved

NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:  
See page 26



12



13



The alkalinity value must be at least 50 mg/l in order to be able to carry out a correct pH measurement.



Для правильного измерения pH значение щелочности должно составлять не менее 50 мг/л.





## 20-PHMB

### PHMB

5 – 60 mg/l (ppm) PHMB

• PHMB Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



1 x PHMB  
Photometer

9



Completely Dissolved  
NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:  
See [page 26](#)



12



13





Be sure to clean all objects that have come into contact with the reagent thoroughly with a brush, water and then distilled water, as otherwise the measuring equipment may turn blue over time. This method is calibrated for alkalinity values (M) = 200 mg/l and calcium hardness values = 200 mg/l. Deviating values can lead to measurement deviations.



Обязательно тщательно очистите все предметы, контактировавшие с реагентом, щеткой, водой, а затем дистиллированной водой, так как в противном случае измерительное оборудование может со временем посинеть. Данный метод откалиброван для значений щелочности (M) = 200 мг/л и кальциевой жесткости = 200 мг/л. Отклонения от этих значений могут привести к отклонениям в измерениях.

OR  
↑  
4.00  
  
2.00  
  
0.00

21-PPLR



## Phosphate LR Фосфат LR

0.00 – 4.00 mg/l (ppm) PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>

PP Phosphate LR N°1 Photometer\*

SP Phosphate LR N°2 Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.



Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.




1



**2****OR****3****4****5**

6

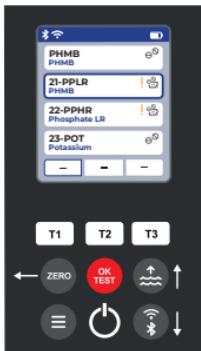

7



8



1 x Phosphate LR N°1  
Photometer

9



10

1 x Phosphate LR N°2  
Photometer

11

Completely  
Dissolved

NO Residue

12



13




14



15







22-PPHR



## Phosphate HR Фосфат HR

0 – 80 mg/l (ppm)  $\text{PO}_4^{3-}$

Phosphate HR N°1 Photometer\*

Phosphate HR N°2 Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.





Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.




1

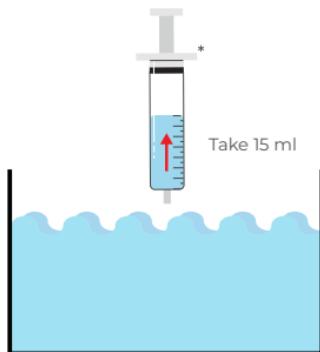

**2****3****4****5**

\*not part of standard equipment

6



Remove 5 ml

7



8



9



10



11



12



13



14



PP

1x Phosphate HR N°1  
Photometer

15



Completely Dissolved

NO Residue

16

E $\ominus$ 1x Phosphate HR N°2  
Photometer

17




Completely Dissolved

NO Residue

18



19

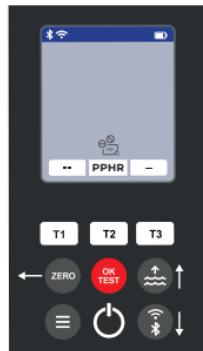

20



21



OR  
↑  
12.0  
+  
+  
+  
6.0  
+  
+  
+  
0.7

23-POT



## Potassium Калий

0.7 – 12.0 mg/l (ppm) K<sup>+</sup>

• Potassium Photometer\*


\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.

Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



9



10



11



If **multiple** parameters:  
See page 26



12



OR  
↑  
100  
+  
+  
+  
50  
+  
+  
+  
5

24-SULF



## Sulphate Сульфаты

5 – 100 mg/l (ppm)  $\text{SO}_4^{2-}$

• Sulphate Photometer\*


\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.

Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



9



10



11



If **multiple** parameters:  
See **page 26**



12



OR  
↑  
500  
250  
0

25-TH

## Total Hardness Общая жесткость

0 – 500 mg/l (ppm) CaCO<sub>3</sub>

- 💧 Total Hardness N°1\*
- 💧 Total Hardness N°2\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



7



8



10 Total Hardness N°1

9



4 Total Hardness N°2

10



11



12




If **multiple** parameters:  
See page 26



13



14

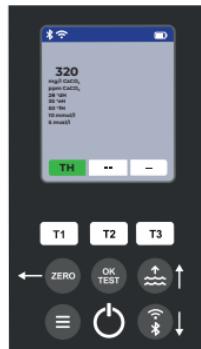





## 26-UREA



# Urea Мочевина

**0.10 – 2.50 mg/l (ppm) ( $\text{NH}_2\text{}_2\text{CO}$ )**

◆ Dechlor\*

◆ PL Urea N°1\*

◆ PL Urea N°2\*

◆ Ammonia N°1 Photometer\*

◆ Ammonia N°2 Photometer\*

\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.




Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по**  
**ZERO** в соответствии со **стр. 18**.



1



**2****OR****3****4****5**

6



If the sample contains chlorine, a Dechlor tablet must be added first.



Если проба содержит хлор, сначала необходимо добавить таблетку Дехлора.

7



8



9



10



11



12



13



14



15

1x Ammonia N°1  
Photometer

16

Completely  
Dissolved

NO Residue

17

1x Ammonia N°2  
Photometer

18

Completely  
Dissolved

NO Residue

19



20




21



22







27-ZINC



## Zinc (with chlorine) Цинк (с хлором)

0.00 – 1.00 mg/l (ppm) Zn<sup>2+</sup>

- Dechlor\*
- Copper/Zinc LR Photometer\*
- EDTA\*


\*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,  
perform the **ZERO steps** as  
per **page 18**.


Если на дисплее отображается  
**ZERO**, выполните **действия по  
ZERO** в соответствии со **стр. 18**.

1



**2****OR****3****4****5**

6

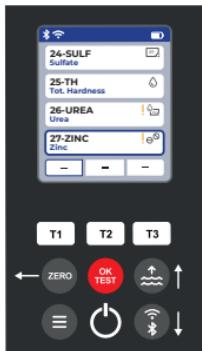

7



8



$\ominus$   
1x Dechlor

9



Completely Dissolved  
  
NO Residue

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24





**CONTACT:**  
**INFO@POOL-ID.COM**



# Certificate of Compliance

We hereby certify that the device



with it's serial number as stated below,  
has passed intensive visual and technical checks  
as part of our QM documentation.  
We confirm the device got factory-calibrated.

Water-i.d.® GmbH (Germany)

Andreas Hock, Managing Director  
Water-i.d.® GmbH | Daimlerstr. 20  
76344 Eggenstein | Germany

**S/N**  
**Manufacturing date**

Water-i.d.® is certified according to ISO 9001:2015